

Fr. 03d249.02 2026-07 © Thommen Medical

Distributeur
Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Suisse
Tél. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

Fabricant
Talladium España, S.L
Virginia Woolf, 17
25005 LLeida | Spain

THOMMEN Medical

Base de titane Dynamic

pour les couronnes transvissées avec rattrapage d'axe

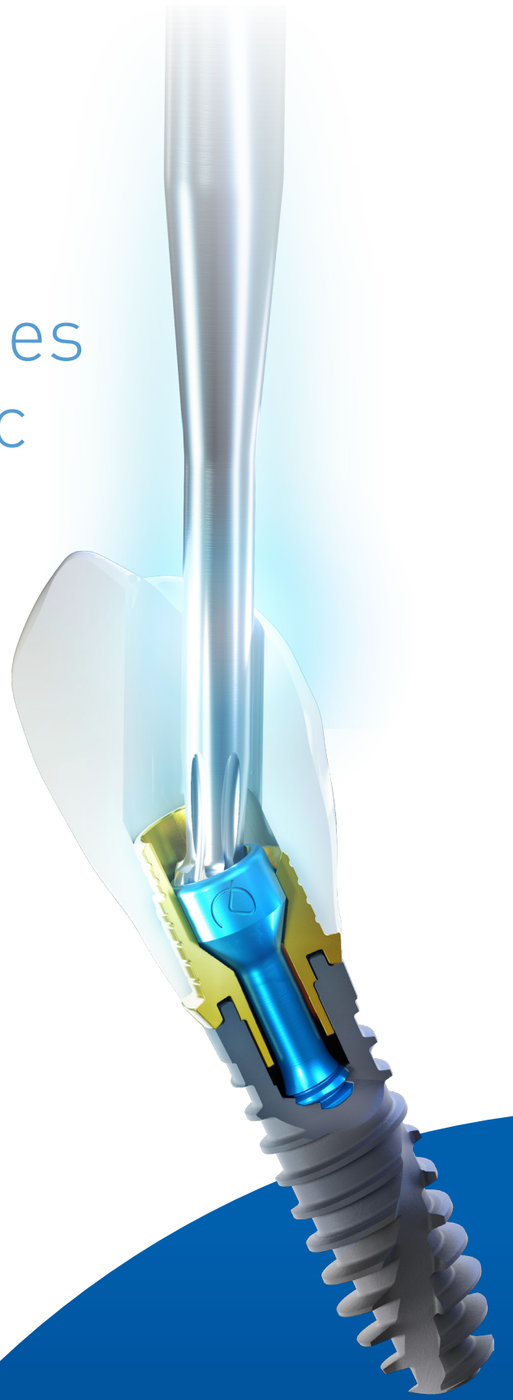

Driven by science, not trends.

Base de titane Dynamic pour Thommen Medical

Flexibilité et autonomie dans le choix de la partie prothétique

Ne laissez plus l'axe de l'implant décider du choix de la réalisation prothétique à votre place. Base de titane Dynamic est parfait pour les restaurations vissées esthétiques et exigeantes. Base de titane Dynamic permet d'anguler le puits de vissage jusqu'à 35 degrés indépendamment de l'axe de l'implant. Vous pouvez ainsi réaliser des restaurations vissées, même dans des cas où il était nécessaire de réaliser des couronnes scellées.

Des bibliothèques CAD/CAM disponibles en ligne accompagnent le flux de travail numérique :

Solution
Base de titane Dynamic Alliage en titane, anodisé



Situation osseuse



Position idéale





Fiable
L'entraînement par vis à 6 lobes permet une fixation sûre de la restauration et autorise une angulation jusqu'à 35°.

Hauteur du pilier	Angle Maximal Removable System	Angle Maximal Captive System
4 mm	35°	28°
5 mm (pilier de 9 mm raccourci)	35°	20°
7 mm (pilier de 9 mm raccourci)	25°	20°
9 mm	25°	20°

Ajustable
Le cylindre à hauteur ajustable permet un soutien optimal de la céramique.
- Pour les implants très enfouis ou les couronnes de grande hauteur en fonction de la situation clinique
- Soutien optimal de la suprastructure
- Adapté aux restaurations temporaires

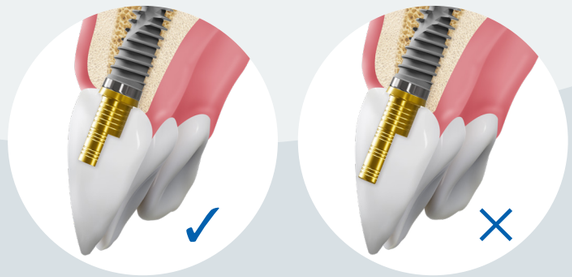

Flexible
- Pour les couronnes et bridges
- Deux types de pilier : standard et à longueur ajustable
- Rainures de rétention circulaires pour les réalisations temporaires

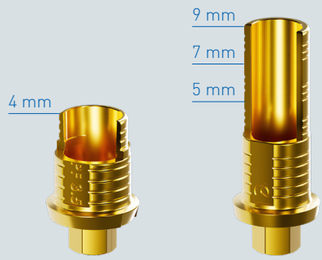

Standard Ajustable

Captive system intelligent
Si la vis est insérée avant le collage.
- Canal de vis de petit diamètre ∅ 2.0 mm
- Le captive system permet de réduire le puits de vissage à 2 mm et permet ainsi d'augmenter le volume et la robustesse de la suprastucture
- La surface occlusale est ainsi augmentée (exemple : occlusion)

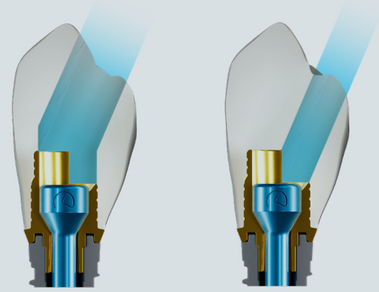

Removable Screw System

Captive Screw System